
Não Conformidade de Materiais


Quando há uma não conformidade de produtos em minha cirurgia, como devo agir?

Para lidar com casos de Não conformidade em cirurgias você pode seguir os seguintes passos:


1- anexar o documento de não conformidade na cirurgia

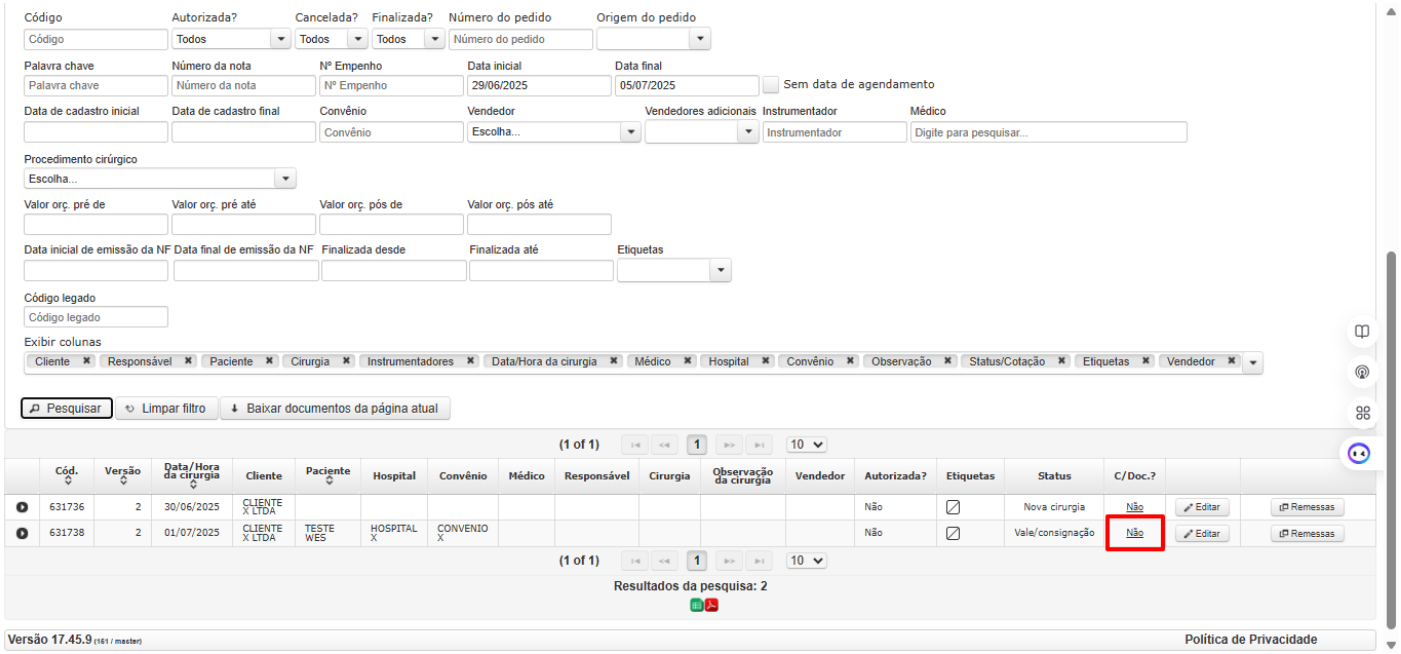

Incluindo o Documento de Não conformidade

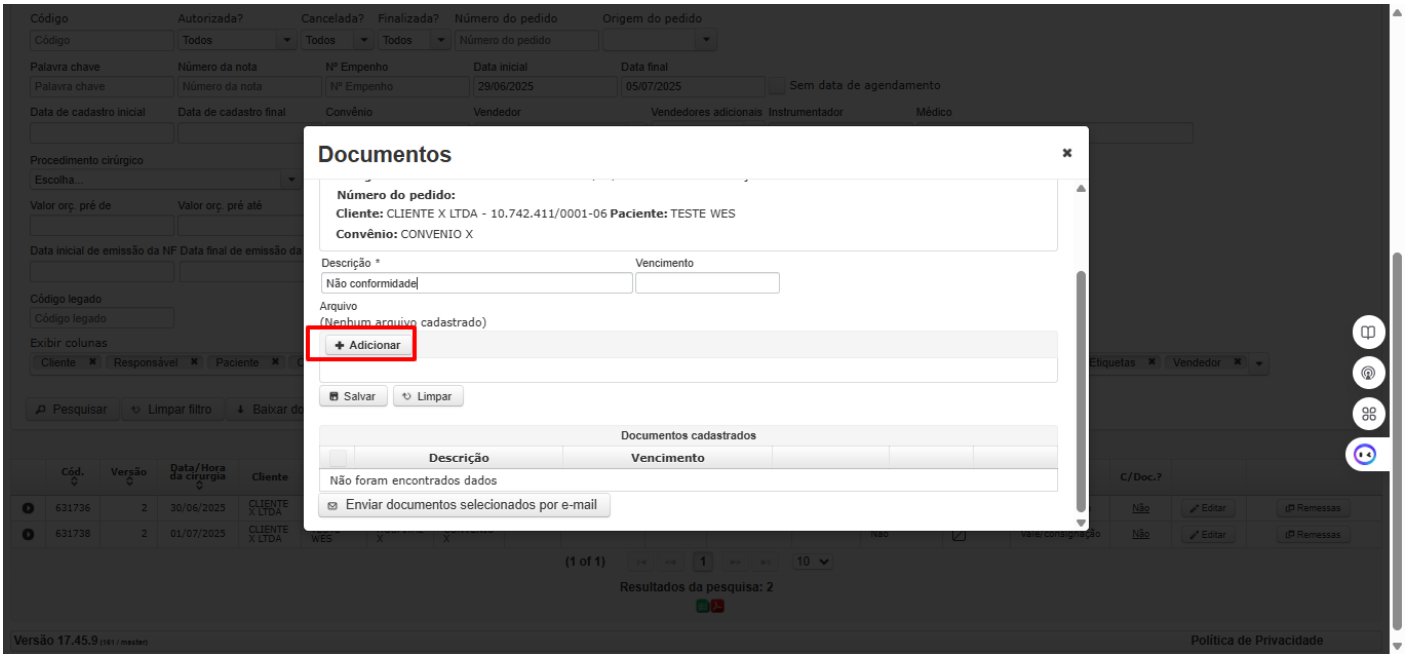


Sendo possível adicionar uma data de vencimento, e gerar alerta para os usuários.

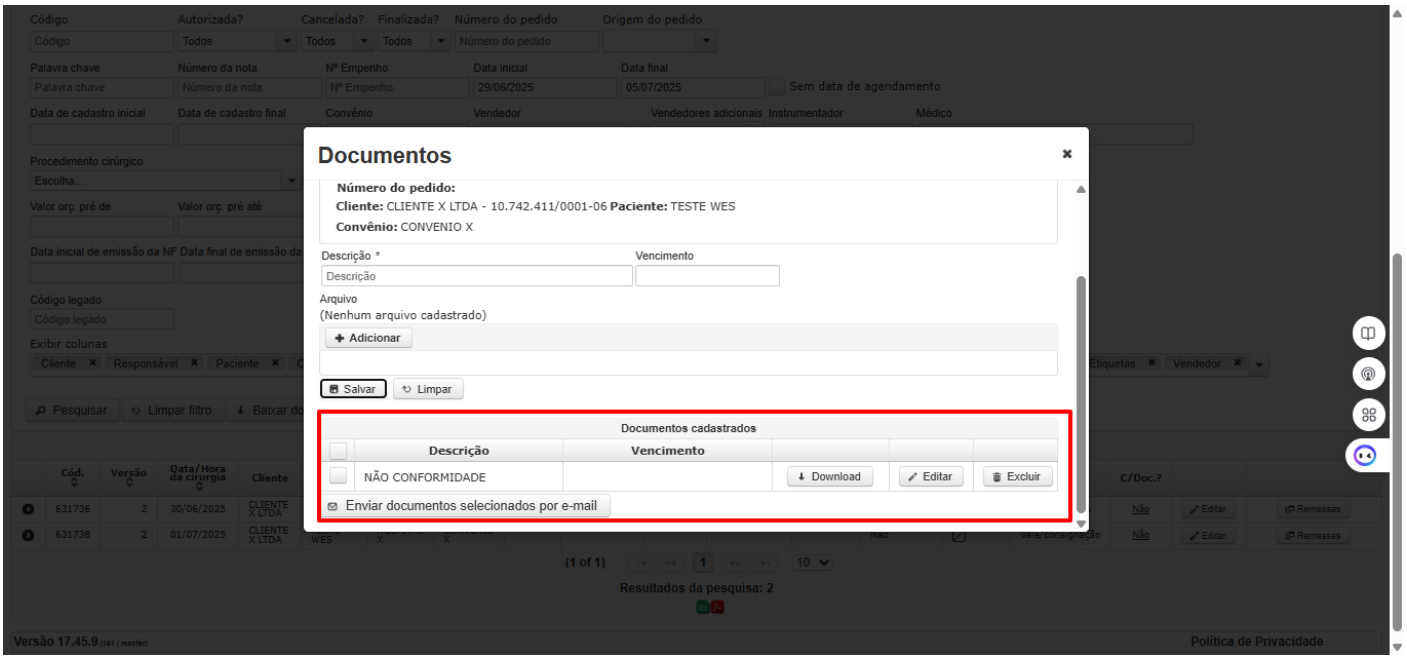


2- Após isso deve ser retirado o produto na cirurgia, segue passo a passo do processo 2.0


Primeiro, retire o material da remessa emitida> clicando em retorno de remessa.

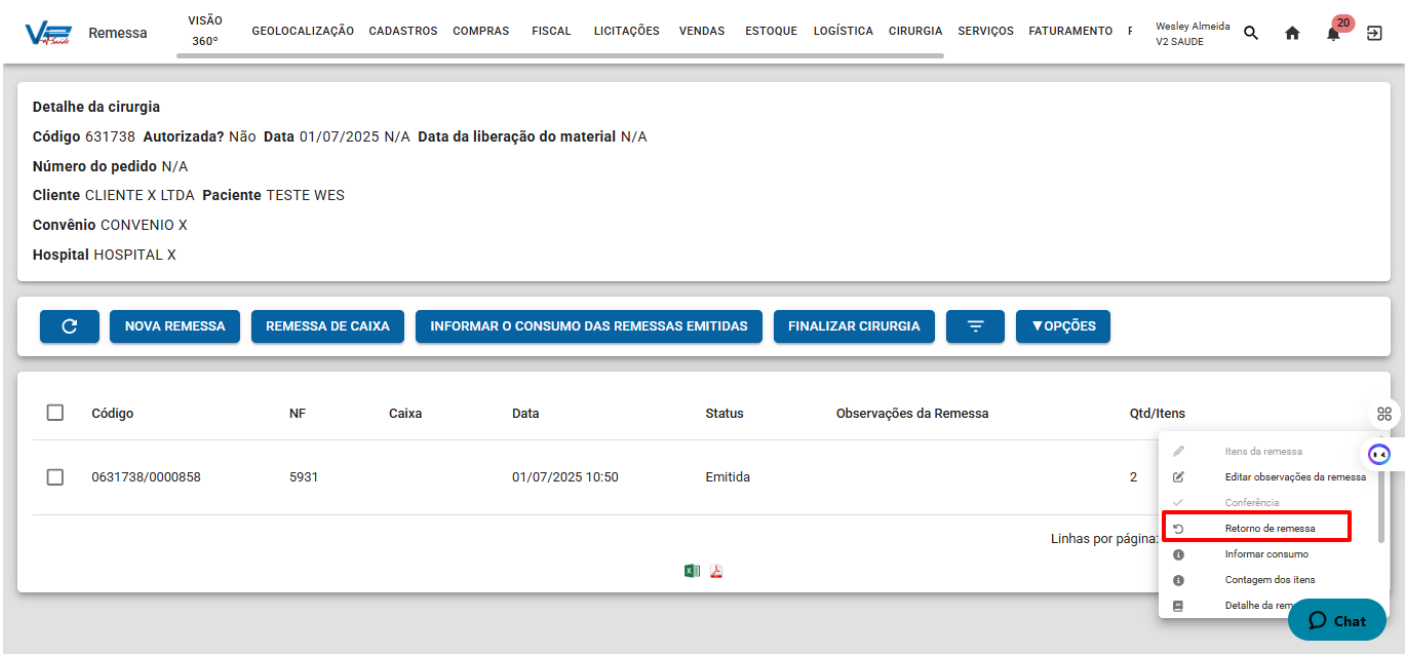


Vamos tratar com 1 unidade do produto A

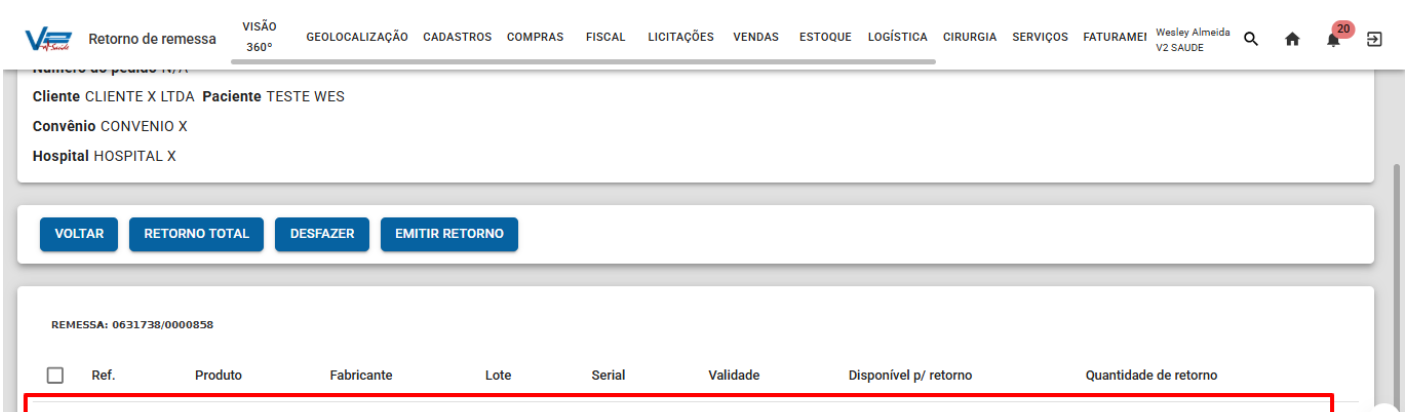


Emita o retorno desta unidade e o item retornará a seu estoque.

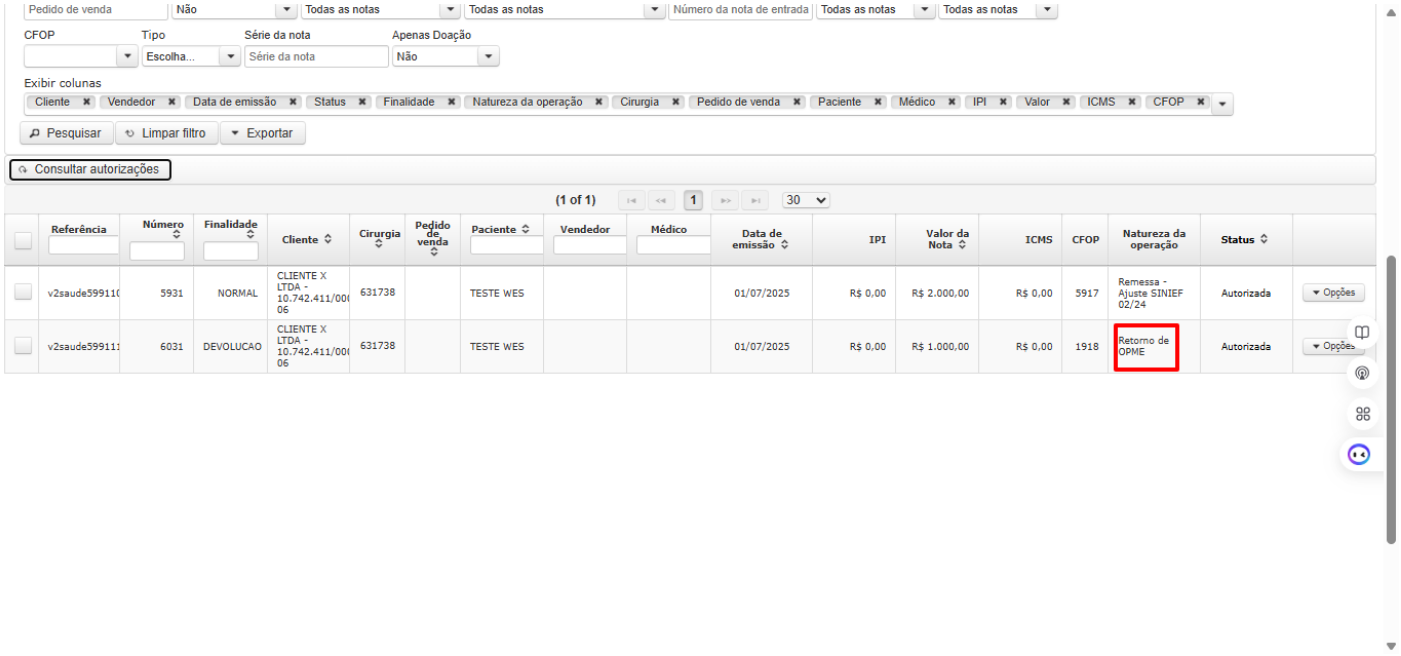


Com o Produto livre em estoque iremos agora colocá-lo em quarentena.

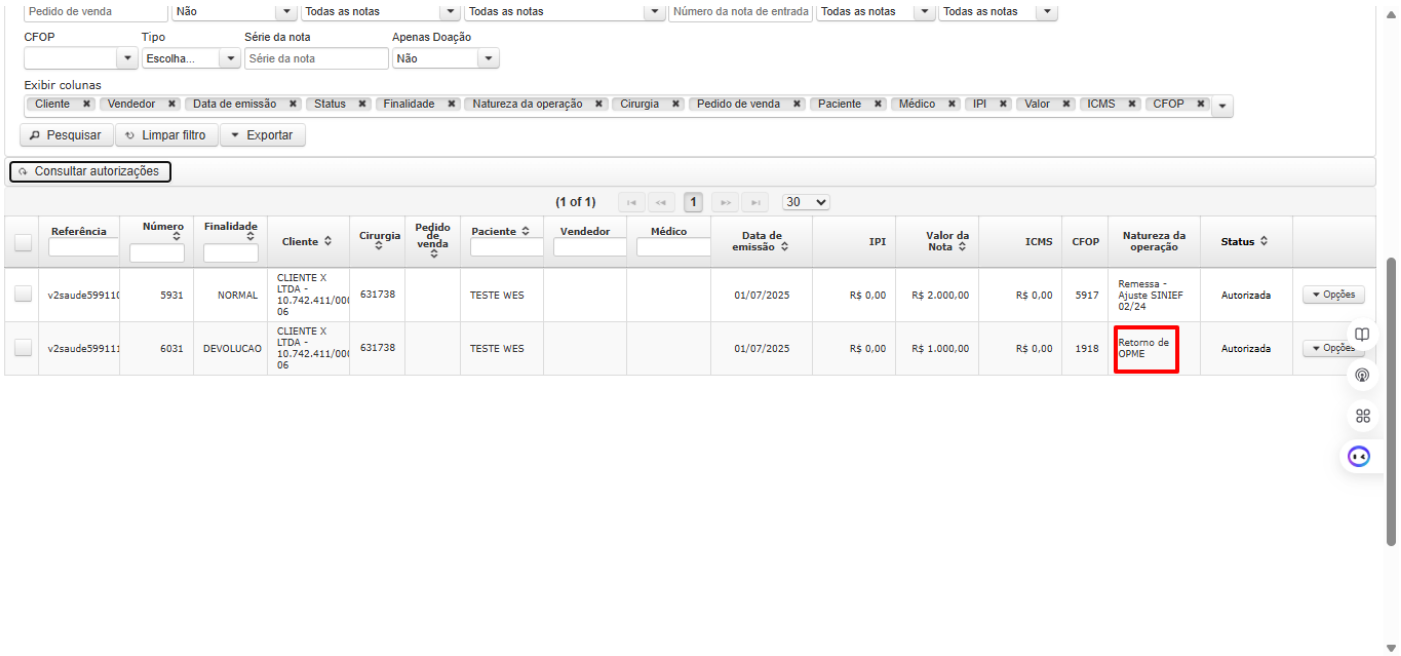


Movimentar o item como "Saida para quarentena."

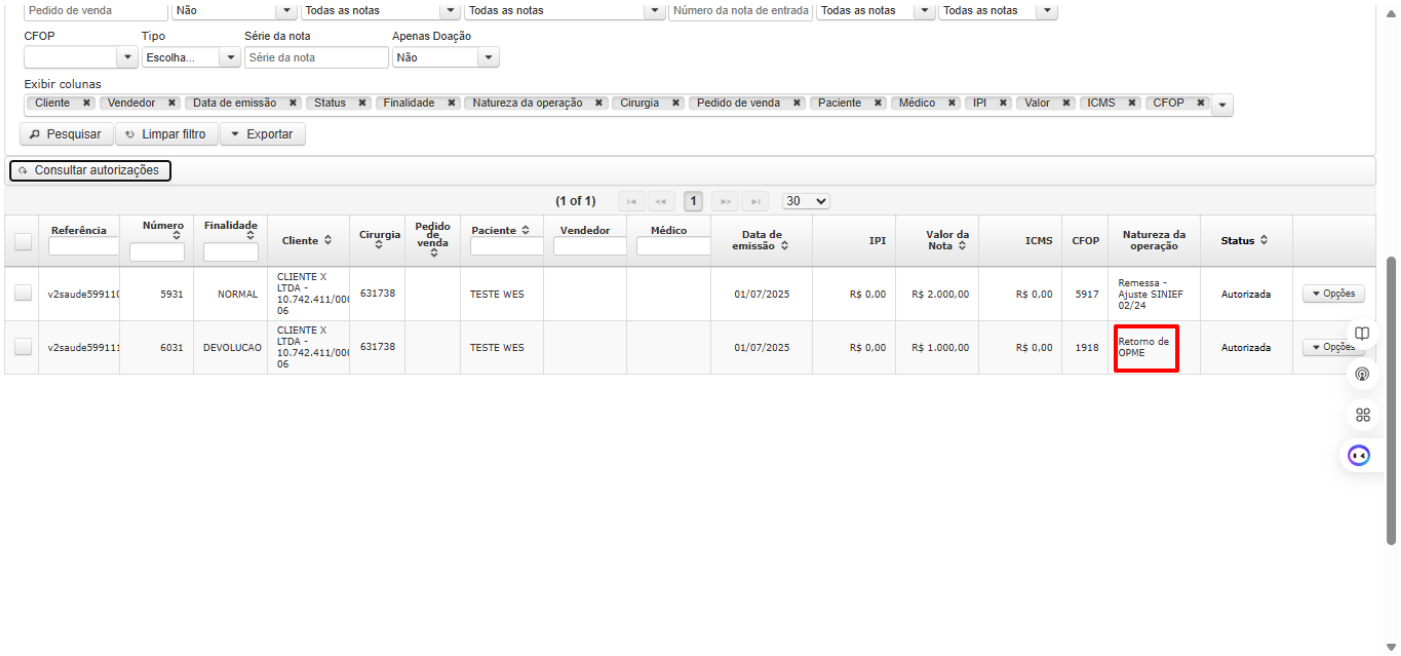

indicando a Não conformidade da cirurgia e documento.

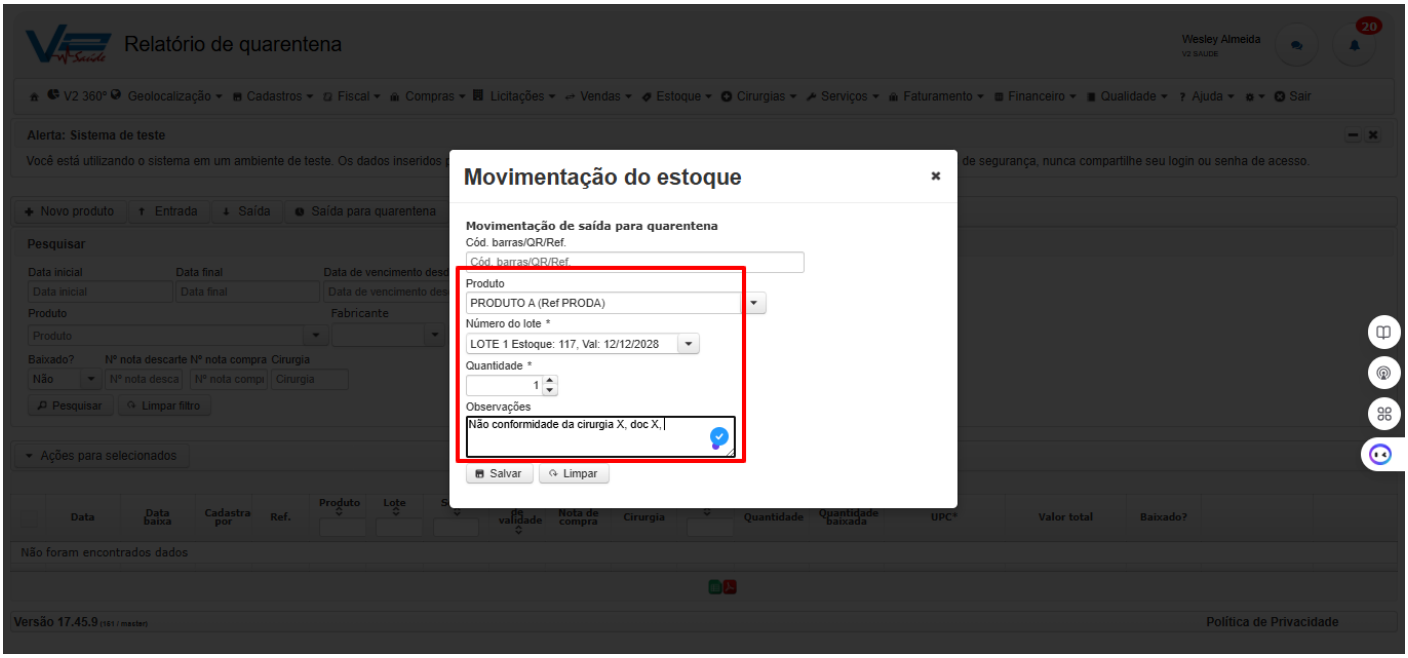

Com esse produto em quarentena, ele ficará separado em seu estoque

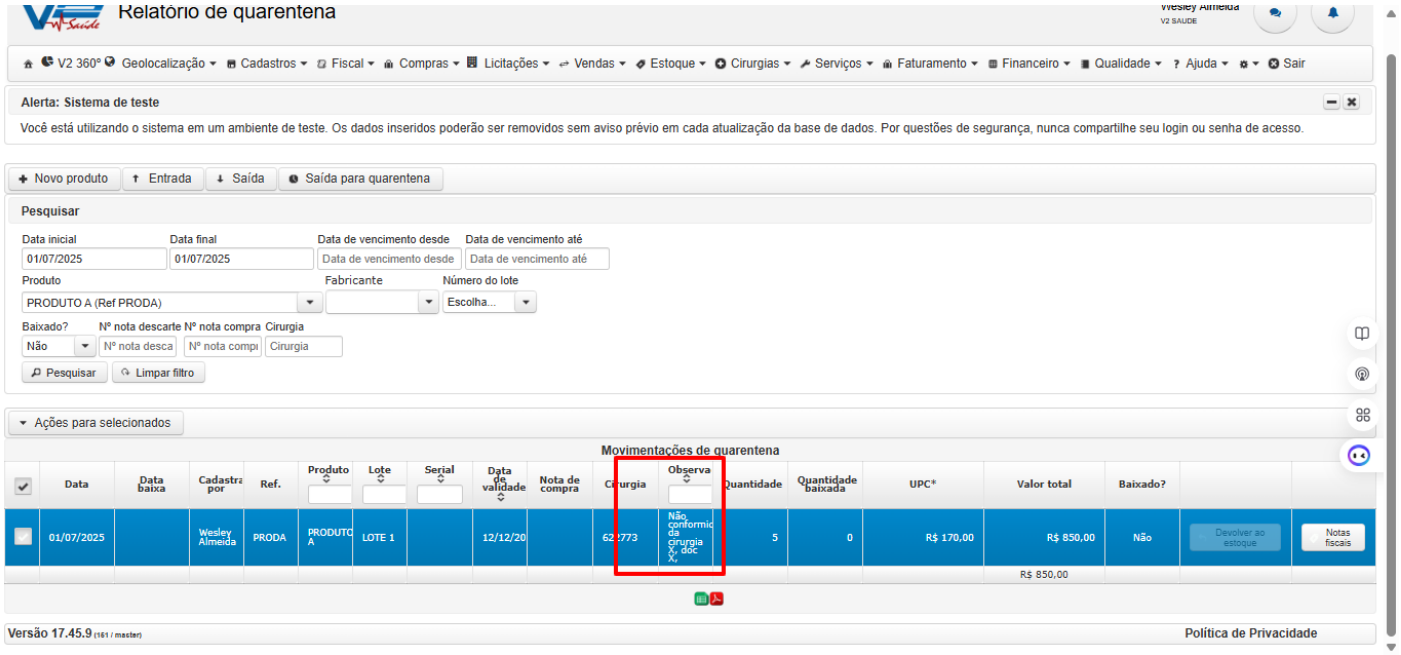

Revision #2
Created 1 July 2025 13:36:59 by Suporte
Updated 1 July 2025 19:39:36 by Suporte